3 neoaspi® - ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS

Flacon de prélèvement aseptique de mucosités, adaptable au système d'aspiration et permettant une **mise en système clos** pour le transport. Dispositif en **double conditionnement stérile** avec fixation adhésive.

DÉSIGNATION	SONDES	CONTENANCE	RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENT
ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS	Non	25 ml	202134	boîte de 75 unités
		40 ml	202117	boîte de 50 unités
ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS PÉDIATRIQUE CH06 et CH10 avec oeillet	Oui	25 ml	202119	boîte de 75 unités
ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS PÉDIATRIQUE CH06 et CH10 sans oeillet	Oui	25 ml	202133	boîte de 75 unités
ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS - CH08 et CH16	Oui	40 ml	202120	boîte de 50 unités
FLACON POUR LAVAGE ALVÉOLAIRE Avec adaptateur universel	Oui	175 ml	202122	boîte de 30 unités

Dispositif médical de classe IIa certifié CE0123 - Fabricant : Polymed

neoaspi® - ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS FIBROSCOPE

DÉSIGNATION	CONTENANCE	RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENT
ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS Pour fibroscope	40 ml	202118	boîte de 50 unités
	100 ml	202121	boîte de 30 unités

Dispositif médical de classe IIa certifié CE0123 - Fabricant : Polymed

202118

202120

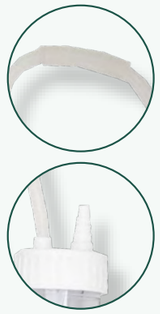

Mise en système clos

- Possibilité de détacher la partie droite de la tubulure
- Fixation sur la partie crantée

4 neovac® - BOUCHON DE DÉCONTAMINATION

Adaptable **pour le rinçage** de l'ensemble **de la ligne d'aspiration.**

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENT
BOUCHON DE RINÇAGE SYSTÈME DE DÉCONTAMINATION - pour flacon 1000 ml	202116	carton de 75 unités
BOUCHON DE RINÇAGE SYSTÈME DE DÉCONTAMINATION - pour flacon 500 ml	202135	carton de 75 unités

Dispositif médical de classe Is certifié CE0123 - Fabricant : Polymed

Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY

9, Avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01

SCANNEZ POUR ACCÉDER AU CONTENU EN LIGNE

DÉCOUVREZ NOTRE SITE SUR **www.aseptinmed.fr**

11/2021 © Asept InMed - Crédit Photo : Fotolia et Asept InMed - Photos non contractuelles - Dispositifs médicaux à usage unique à destination de l'aspiration oropharyngée, du recueil du produit d'aspiration, de l'évacuation des voies aériennes et de l'aspiration trachéobronchique - Classes, fabricants et certifications précisés sous chaque tableau de références - Veuillez vous référer à la notice pour plus d'informations. Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage. Documentation à destination des professionnels de santé.

PNEUMOLOGIE
SOINS INTENSIFS

ACCESSOIRES D'ASPIRATION

Une gamme complète de **dispositifs d'aspiration bronchique**

- De la pédiatrie à l'adulte
- De la prise murale jusqu'à la sonde d'aspiration
- Pour la réalisation d'analyse des mucosités

www.aseptinmed.fr

Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY

ACCESSOIRES D'ASPIRATION, UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS ET TOUS LES PATIENTS.

PROCÉDURE DE MONTAGE

Les différents dispositifs proposés par Asept InMed permettent la réalisation des divers **montages d'aspiration nasales et trachéales.**

MONTAGE ASPIRATION **POUR ÉVACUATION**

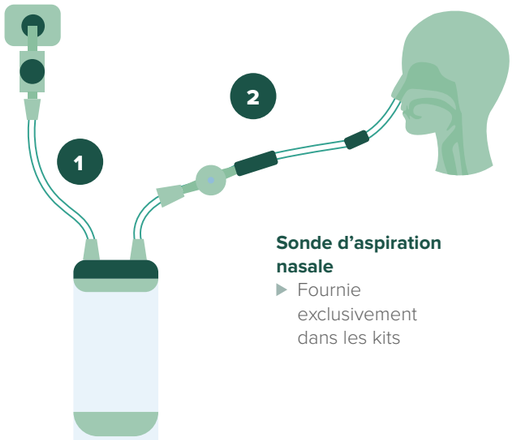

Sonde d'aspiration nasale
- Fournie exclusivement dans les kits

MONTAGE ASPIRATION **POUR RINÇAGE**

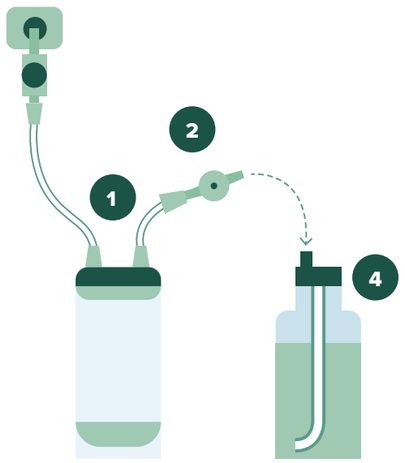

MONTAGE ASPIRATION CLASSIQUE **POUR ANALYSE**

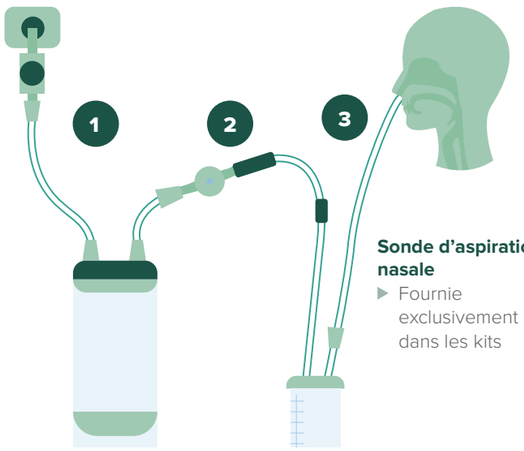

Sonde d'aspiration nasale
- Fournie exclusivement dans les kits

MONTAGE ASPIRATION FIBROSCOPE **POUR ANALYSE**

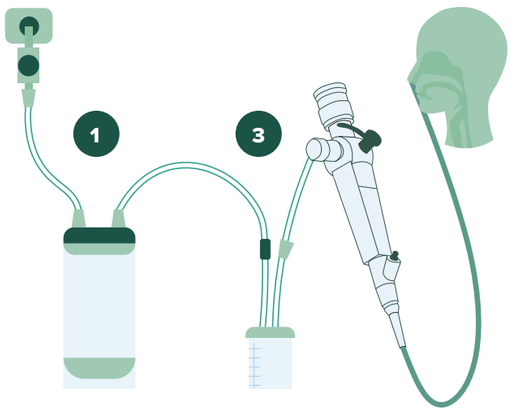

1 neotube® - TUBULURES D'ASPIRATION

Raccordement des valves d'aspiration à la source de vide.

À DOUBLE GODETS - neotube®

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENT
TUBULURE À GODETS Stérile	Ø interne 5 / Lg 180cm	202050	carton de 35 unités
	Ø interne 5 / Lg 300cm	202051	carton de 30 unités
	Ø interne 7 / Lg 180cm	202047	carton de 30 unités
	Ø interne 7 / Lg 210cm	202112	carton de 30 unités
	Ø interne 7 / Lg 270cm	202113	carton de 25 unités
	Ø interne 7 / Lg 300cm	202048	carton de 25 unités

Dispositif médical de classe IIa certifié CE0123 - Fabricant Polymed - double conditionnement stérile

À GODETS - neotube®

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENT
TUBULURE À GODETS Coupe droite, stérile	Ø interne 7 / Lg 210cm	202049	carton de 25 unités

Dispositif médical de classe IIa certifié CE2460 - Fabriquant : Polymed - Double conditionnement stérile

EN ROULEAU SÉCABLE

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENT
TUBULURE D'ASPIRATION Rouleau 30 m sécable tous les 90 cm Non stérile	Ø 7mm x 10mm	202052	carton de 4 unités
	Ø 5mm x 8mm	202053	carton de 6 unités

Dispositif médical de classe I - Fabricant Polymed

2 neovalve® - VALVE D'ARRÊT DE VIDE

Système manuel de contrôle d'aspiration transparent, **maîtrise de l'aspiration en toute asepsie.**

Tubulure avec diamètre interne 7 mm.

DÉSIGNATION	STÉRILE	RÉFÉRENCES		
		Ø TUBULURE	1m80	3m
VALVE D'ARRÊT DE VIDE ADULTE	Non	202039		
	Oui	202040	202043	202044
VALVE D'ARRÊT DE VIDE PÉDIATRIQUE	Non	202041		
	Oui	202042	202046	202045

Dispositif médical de classe I (non stérile) certifié CE - Dispositif médical de classe Is (stérile) certifié CE2460 - Fabricant PolyMedicure
Cdt - 50 unités pour les références 202039 à 202042
Cdt - 30 unités pour les références 202043 et 202046
Cdt - 25 unités pour les références 202044 à 202045

Caractéristiques
- Embout godet
- Embout pédiatrique pour des sondes petits godets