BOUTON MIC-KEY®
REMPLACEMENT

Le **1er remplacement se fait en général par le médecin** pour mesurer l'épaisseur de la paroi abdominale. Il peut ensuite s'effectuer, après formation préalable, par le médecin traitant, l'infirmièr(e), le patient ou une personne de son entourage*.

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

- Eau stérile (hôpital), minérale (domicile)
- Gel hydrosoluble
- Un kit MIC-KEY® (contrôler l'intégrité de l'emballage).

R Toujours se laver les mains avant utilisation.



INTÉGRITÉ DU NOUVEAU BOUTON

- Contrôler la symétrie et l'absence de fuite au niveau du ballonnet en connectant une seringue sur le site "BAL", avec la quantité d'eau appropriée : 3ml : CH12
  5ml : CH14 à CH24.

LUBRIFICATION

- Lubrifier la sonde du bouton à l'eau ou à l'aide d'un gel hydrosoluble.

R Ne jamais utiliser de produits à dérivés pétroliers ou à corps gras.



RETRAIT DU BOUTON

- Connecter la seringue sur le site "BAL".
  Dégonfler le ballonnet et retirer le bouton en place.



INTRODUCTION DU BOUTON

- Dégonfler le ballonet du nouveau bouton et l'introduire dans la gastrostomie sans forcer.



GONFLEMENT DU BALLONNET

- Connecter la seringue remplie avec le volume d'eau préconisé :
  3ml : CH12 / 5ml : CH14 à CH24
  Gonfler le ballonnet.

R Ne jamais gonfler à l'air ni avec du serum physiologique. Volume max. 10 ml.

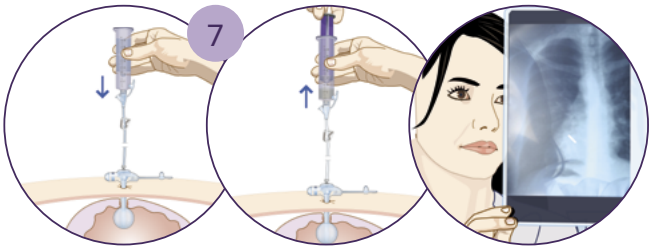

VÉRIFICATION DU BON POSITIONNEMENT

- Par gravité : en visualisant la baisse du niveau d'eau dans la seringue via le prolongateur.
- Par aspiration : du contenu gastrique avec une seringue via le prolongateur connecté au bouton.
- A la radiologie : Obligatoire lors du 1er changement et/ou si anomalie lors de la pose.

FRÉQUENCE DE CHANGEMENT

2 à 4 fois par an en cas :** d'usure de la valve anti-retour du site d'alimentation ou du ballonnet qui varie selon l'hyper acidité gastrique du patient, l'entretien et certains médicaments, de ballonnet percé, déchiré ou poreux, d'évolution de la morphologie abdominale ou d'obstruction de la sonde.

* Guide de bonnes pratiques de nutrition artificielle à domicile - Edition 2014 - Les éditions de la SFNCM - EAN9782914558860
**Conformément à l'Arrêté du 17/11/09 paru au JO

Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY

9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01

SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU CONTENU EN LIGNE
www.aseptinmed.fr

12/2021 © Asept InMed - Fabricant : Avanos - Crédit Photo : Avanos, Zanatan et Fotolia - Photos non contractuelles - Dispositif médical stérile à usage unique de classe IIb certifié CE2797 destiné à la nutrition entérale - Veuillez vous référer à la notice pour plus d'informations. Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage. Document à l'usage des professionnels de santé.