UROLOGIE
ENDOSCOPIE

TUTEURS URÉTÉRAUX
DOUBLE J

CATALOGUE

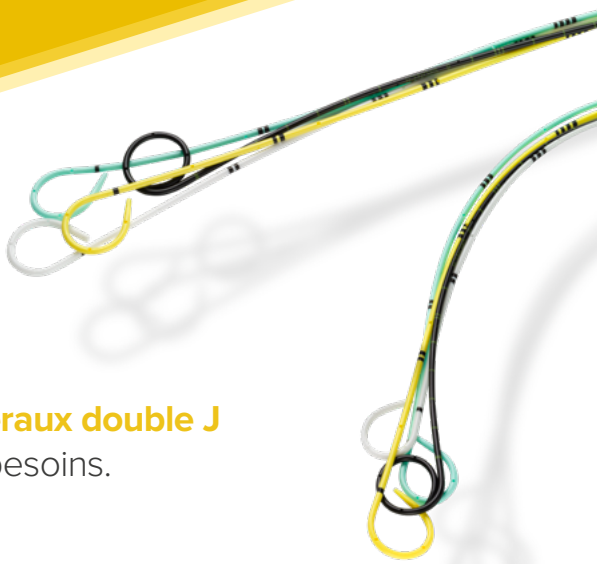

Une gamme complète de **tuteurs urétéraux double J** s'adaptant à l'ensemble de vos besoins.

- Courte durée
- Moyenne durée
- Longue durée et tumeurs

Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY

www.aseptinmed.fr

LA TECHNOLOGIE HYBRID PRO DANS NOS STENTS URÉTÉRAUX.

- Répond aux **exigences** dans les différentes phases de l'application
- **Stabilité** lors du positionnement – souplesse pendant le séjour
- Jusqu'à **50% plus souple** après 30 minutes à température corporelle[1]

▶ Depuis de nombreuses années, **les stents urétéraux sont devenus des outils complets dans le traitement ou la prévention** des obstructions urétérales de calculs et d'autres causes.

▶ Malgré les nombreux avantages offerts par les endoprothèses urétérales à cet égard, elles sont souvent associées à des **symptômes irritants des voies urinaires inférieures**, à la vessie ou à l'abdomen, qui pourraient avoir un effet négatif sur la qualité de vie des patients[2].

▶ L'inconfort de l'endoprothèse urétérale peut varier d'un patient à l'autre, mais toucherait plus de 80 % d'entre eux[3,4]

▶ Notre objectif est de **fournir au praticien et au patient une expérience optimale** avec nos produits. Par conséquent, les stents urétéraux UROTECH sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité composés de la technologie HybridPRO.

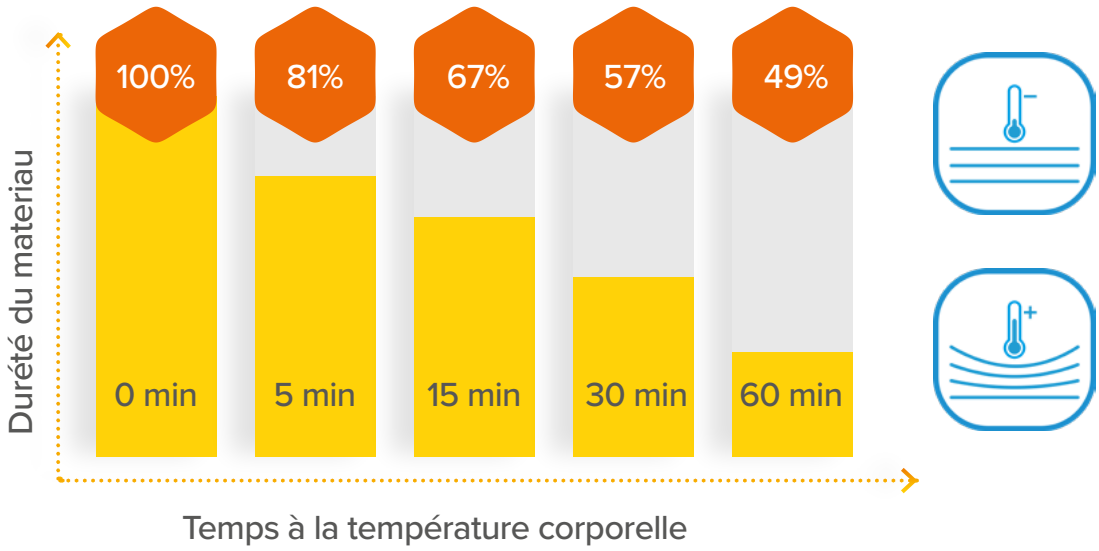

HybridPRO® TECHNOLOGY

▶ Le **matériau utilisé** dans la technologie HybridPRO pour nos stents urétéraux **répond aux exigences des différentes phases de l'application**.

▶ La formation partielle spéciale des chaînes moléculaires dans le matériau à température ambiante (appelées cristallites) **assure une texture ferme** et, par conséquent, un positionnement simplifié des stents grâce à une transmission de force linéaire et axiale améliorée.

▶ Pendant le temps de séjour, **cette formation des chaînes moléculaires s'égalise à la température du corps, assurant ainsi un matériau souple et flexible dans les voies urinaires**.

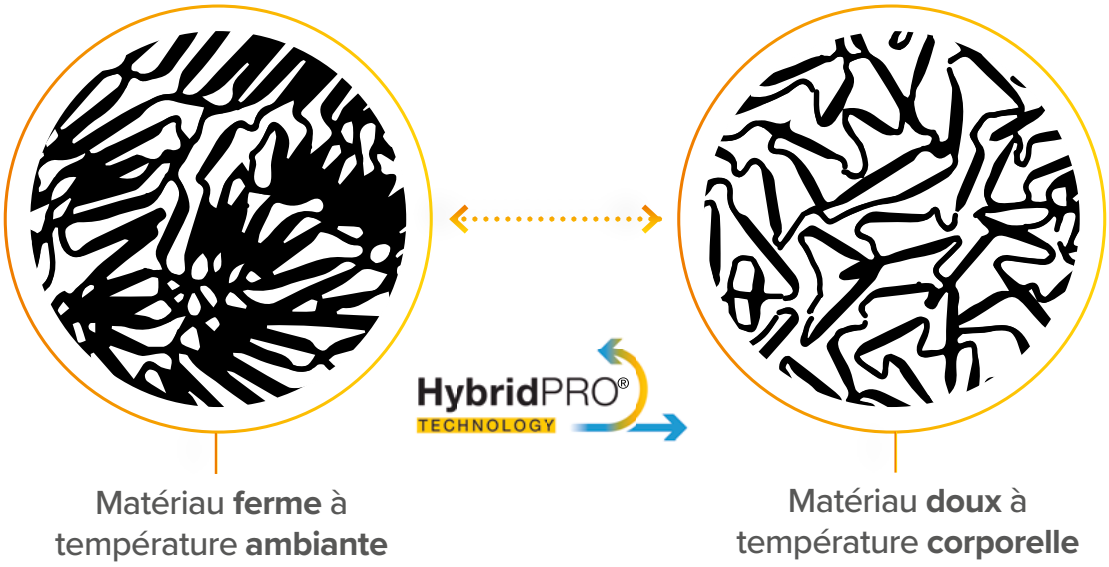

1. Test report (7 FR White-Star). Medi-Globe Technologies GmbH. 2022. Data on file (PRB-1736)

2. Niu JR, Ji ZG, Rong S, Mao QZ, Fan H, He X. Ureteral Stent Fragmentation: a Case Report and Review of Literature. Chin Med Sci J. 2013 Jun;28(2):124-6. doi: 10.1016/S1001-9294(13)60035-8

3. Joshi HB, Okeke A, Newns N, Keeley FX Jr, Timoney AG. Characterization of urinary symptoms in patients with ureteral stents. Urology. 2002 Apr;59(4):511-6. doi: 10.1016/s0090-4295(01)01644-2. PMID: 11927301.

4. Byrne RR, Auge BK, Kourambas J, Munver R, Delvecchio F, Preminger GM. Routine ureteral stenting is not necessary after ureteroscopy and ureteropyeloscopy: a randomized trial. J Endourol. 2002. Feb;16(1):9-13. doi: 10.1089/089277902753483646. PMID: 11890453.

KIT TUTEUR URÉTÉRAL **DOUBLE J COURTE DURÉE**

MAGNETIC BLACK-STAR®

HybridPRO® TECHNOLOGY

Aimant côté vessie
- Pour retrait par attraction magnétique sans 2nde cystoscopie

Dispositif de récupération à aimant
- Orientation du dispositif grâce à la ligne de repérage et l'embout Tiemman, béquillé à 30°

Fabriqué en polyuréthane (PUR)
- PUR souple
- Lumière interne importante
- Force de rétention importante

Tuteur urétéral
- Orifices de drainage le long des crosses et du corps
- Embout ouvert

Radio-opaque + marqueur de positionnement
- Pour une visibilité en fluoroscopie et macroscopie

Du fait de la présence d'aimant, ce dispositif ne peut pas être implanté chez des patients porteurs de stimulateurs cardiaques

IRM interdit durant le port de ce dispositif

De nombreuses études sont disponibles sur demande

Contenu du Kit

Magnetic Black-Star®
Tuteur urétéral double J

Poussoir
Longueur : 40 cm

Dispositif de récupération*

*Selon les références

DISPOSITIF DE RÉCUPÉRATION À AIMANT SEUL

DÉSIGNATION	TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
DISPOSITIF DE RÉCUPÉRATION valable pour tuteur 4,8 FR/CH	09	40 cm	221540	R-DEVICE-S
DISPOSITIF DE RÉCUPÉRATION valable pour tuteur 6 et 7 FR/CH	15	40 cm	221541	R-DEVICE-L

Dispositif médical de classe IIa - Conditionnement : unitaire

KIT TUTEUR URÉTÉRAL **DOUBLE J COURTE DURÉE**

KIT TUTEUR URÉTÉRAL DOUBLE J AVEC ET SANS DISPOSITIF DE RÉCUPÉRATION À AIMANT

RÉFÉRENCES avec dispositif de récupération		RÉFÉRENCES sans dispositif de récupération		TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR	TAILLE AIMANT (FR/CH)	Ø MAX FIL GUIDE (POUCE)
Commande	Produit	Commande	Produit				
222073	MR-414810	222300	MR-404810	4,8	10 cm	07	0,028 ”
222074	MR-414812	222301	MR-404812	4,8	12 cm	07	0,028 ”
222075	MR-414815	222302	MR-404815	4,8	15 cm	07	0,028 ”
222370	MR-414818	222362	MR-404818	4,8	18 cm	07	0,028 ”
222076	MR-414820	222303	MR-404820	4,8	20 cm	07	0,028 ”
222371	MR-414822	222363	MR-404822	4,8	22 cm	07	0,028 ”
221528	MR-414824	222304	MR-404824	4,8	24 cm	07	0,028 ”
221529	MR-414826	222305	MR-404826	4,8	26 cm	07	0,028 ”
222364	MR-410615	222356	MR-400615	06	15 cm	09	0,035 ”
222365	MR-410618	222357	MR-400618	06	18 cm	09	0,035 ”
222366	MR-410620	222358	MR-400620	06	20 cm	09	0,035 ”
222113	MR-410622	222294	MR-400622	06	22 cm	09	0,035 ”
221530	MR-410624	222295	MR-400624	06	24 cm	09	0,035 ”
221531	MR-410626	222296	MR-400626	06	26 cm	09	0,035 ”
222367	MR-410715	222359	MR-400715	07	15 cm	09	0,035 ”
222368	MR-410718	222360	MR-400718	07	18 cm	09	0,035 ”
222369	MR-410720	222361	MR-400720	07	20 cm	09	0,035 ”
222355	MR-410722	222297	MR-400722	07	22 cm	09	0,035 ”
221532	MR-410724	222298	MR-400724	07	24 cm	09	0,035 ”
221533	MR-410726	222299	MR-400726	07	26 cm	09	0,035 ”

Dispositif médical de classe IIb
Conditionnement : unitaire

KIT TUTEUR URÉTÉRAL **DOUBLE J COURTE DURÉE**

MAGNETIC BLACK-STAR® XS

HybridPRO® TECHNOLOGY

Pas de deuxième cystoscopie ni d'anesthésie générale chez l'enfant.

Aimant côté vessie
- Taille de l'aimant réduite à 4,8fr pour une utilisation aisée en pédiatrie à la fois lors d'interventions en rétrograde et en antégrade

Fabriqué en polyuréthane (PUR)
- PUR souple
- Lumière interne importante
- Force de rétention importante

Tuteur urétéral
- Orifices de drainage le long des crosses et du corps
- Embout ouvert

Radio-opaque + marqueur de positionnement
- Pour une visibilité en fluoroscopie et macroscopie

Du fait de la présence d'aimant, ce dispositif ne peut pas être implanté chez des patients porteurs de stimulateurs cardiaques

IRM interdit durant le port de ce dispositif

De nombreuses études sont disponibles sur demande

Contenu du Kit

Magnetic Black-Star®XS
Tuteur urétéral double J

Poussoir
Longueur : 40 cm

Dispositif de récupération*

*Selon les références

DISPOSITIF DE RÉCUPÉRATION À AIMANT SEUL

DÉSIGNATION	TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
DISPOSITIF DE RÉCUPÉRATION valable pour tuteur 4,8 FR/CH	09	40 cm	221540	R-DEVICE-S

Dispositif médical de classe IIa - Conditionnement : unitaire

KIT TUTEUR URÉTÉRAL **DOUBLE J COURTE DURÉE**

Kit tuteur urétéral double J XS **sans** dispositif de récupération à aimant

RÉFÉRENCES		TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR	TAILLE AIMANT (FR/CH)	Ø MAX FIL GUIDE (POUCE)
Commande	Produit				
222504	MR-404810-XS	4,8	10 cm	4,8	0,028 ”
222505	MR-404812-XS	4,8	12 cm		
222506	MR-404815-XS	4,8	15 cm		
222507	MR-404818-XS	4,8	18 cm		
222508	MR-404820-XS	4,8	20 cm		
222509	MR-404822-XS	4,8	22 cm		
222510	MR-404824-XS	4,8	24 cm		
222511	MR-404826-XS	4,8	26 cm		

Dispositif médical de classe IIb - Conditionnement : unitaire

Kit tuteur urétéral double J XS **avec** dispositif de récupération à aimant

RÉFÉRENCES		TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR	TAILLE AIMANT (FR/CH)	Ø MAX FIL GUIDE (POUCE)
Commande	Produit				
222512	MR-414810-XS	4,8	10 cm	4,8	0,028 ”
222513	MR-414812-XS	4,8	12 cm		
222514	MR-414815-XS	4,8	15 cm		
222515	MR-414818-XS	4,8	18 cm		
222516	MR-414820-XS	4,8	20 cm		
222517	MR-414822-XS	4,8	22 cm		
222518	MR-414824-XS	4,8	24 cm		
222519	MR-414826-XS	4,8	26 cm		

Dispositif médical de classe IIb - Conditionnement : unitaire

KIT TUTEUR URÉTÉRAL **DOUBLE J COURTE DURÉE**

WHITE-STAR

Gamme **White-Star** : notre solution la plus économique

Fabriqué en polyuréthane (PUR)
- PUR souple
- Lumière interne importante
- Force de rétention importante

Tuteur urétéral
- Orifices de drainage le long des crosses et du corps
- Embout ouvert

Radio-opaque + marqueurs de positionnement
- Pour une visibilité en fluoroscopie et macroscopie

Contenu du Kit

Tuteur urétéral

Dispositif d'orientation
Longueur : 43 cm

Dispositif d'orientation avec raccord
- Poussoir
- Déconnecteur
- Raccord de fixation

KIT TUTEUR URÉTÉRAL **DOUBLE J COURTE DURÉE**

LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES		TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	Ø MAX FIL GUIDE	ORIENTABLE	RACCORD
Commande	Produit					
221162	ES-570626	06	26	0,035”	x	x
221163	ES-570628	06	28	0,035”		
221164	ES-570630	06	30	0,035”		
221165	ES-570724	07	24	0,035”		
221166	ES-570726	07	26	0,035”		
221167	ES-570728	07	28	0,035”		
221168	ES-570730	07	30	0,035”		
221159	ES-570524	4,7	24	0,028”		
221160	ES-570526	4,7	26	0,028”		

DM de classe IIb - Conditionnement : par 10

KIT TUTEUR URÉTÉRAL **DOUBLE J COURTE & MOYENNE DURÉE**

GREEN-STAR

HybridPRO® TECHNOLOGY

Fabriqué en polyuréthane (PUR)
- PUR souple
- Lumière interne importante
- Force de rétention importante

Tuteur urétéral
- Orifices de drainage le long des crosses et du corps
- Embout ouvert

Radio-opaque + marqueurs de positionnement
- Pour une visibilité en fluoroscopie et macroscopie

Contenu du Kit

Tuteur urétéral



Dispositif d'orientation*
Longueur : 43 cm

Dispositif d'orientation avec raccord*
- Poussoir
- Déconnecteur
- Raccord de fixation

* Selon les références

KIT TUTEUR URÉTÉRAL **DOUBLE J COURTE & MOYENNE DURÉE**

LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES		TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	Ø MAX FIL GUIDE	ORIEN-TABLE	RACCORD
Commande	Produit					
221265	EG-410622-30-BS	06	22 - 30	0,035”		
221266	EG-410722-30-BS	07	22 - 30	0,035”		
221267	EG-410822-30-BS	08	22 - 30	0,035”		
221218	EG-410626	06	26	0,035”		
221219	EG-410628	06	28	0,035”		
221220	EG-410630	06	30	0,035”		
221221	EG-410724	07	24	0,035”		
221222	EG-410726	07	26	0,035”		
221223	EG-410728	07	28	0,035”		
221224	EG-410730	07	30	0,035”		
221226	EG-410826	08	26	0,035”		
221227	EG-410828	08	28	0,035”		
221274	EG-470624	06	24	0,035”	x	
221275	EG-470626	06	26	0,035”	x	
221276	EG-470628	06	28	0,035”	x	
221277	EG-470630	06	30	0,035”	x	
221278	EG-470724	07	24	0,035”	x	
221279	EG-470726	07	26	0,035”	x	
221280	EG-470728	07	28	0,035”	x	
221281	EG-470730	07	30	0,035”	x	
221282	EG-470824	08	24	0,035”	x	
221283	EG-470826	08	26	0,035”	x	
221284	EG-470828	08	28	0,035”	x	
221285	EG-470830	08	30	0,035”	x	
221310	EG-570624	06	24	0,035”	x	x
221311	EG-570626	06	26	0,035”	x	x
221312	EG-570628	06	28	0,035”	x	x
221314	EG-570724	07	24	0,035”	x	x
221315	EG-570726	07	26	0,035”	x	x
221316	EG-570728	07	28	0,035”	x	x
221317	EG-570730	07	30	0,035”	x	x

DM de classe IIb - Conditionnement : par 10

KIT TUTEUR URÉTÉRAL **DOUBLE J LONGUE DURÉE**

YELLOW-STAR

HybridPRO® TECHNOLOGY

Biocompatibilité 12 mois [1]

Fabriqué en polyuréthane (PUR)
- Lumière interne importante
- Force de rétention importante

Orifices de drainage
- Placés le long des crosses et du corps

Revêtement phosphorylchoine [1] [2] [3]
- Limite le risque d'incrustation et d'infection, pour une utilisation de longue durée
- Morbidité minimisée[1]

Tuteur urétéral
- Orifices de drainage le long des crosses et du corps
- Embout ouvert
- Revêtement hydrophile

Radio-opaque + marqueurs de positionnement
- Pour une visibilité en fluoroscopie et macroscopie

LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES		TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	Ø MAX FIL GUIDE	ORIENTABLE	RACCORD
Commande	Produit					
220900	EP-414724	4,7	24	0,028”		
220901	EP-414726	4,7	26	0,028”		
220902	EP-410624	06	24	0,035”		
220903	EP-410626	06	26	0,035”		
220904	EP-410628	06	28	0,035”		
220905	EP-410630	06	30	0,035”		
220906	EP-410724	07	24	0,035”		
220907	EP-410726	07	26	0,035”		
220908	EP-410728	07	28	0,035”		
220909	EP-410730	07	30	0,035”		
220910	EP-410824	08	24	0,035”		
220911	EP-410826	08	26	0,035”		
220912	EP-410828	08	28	0,035”		
220913	EP-410830	08	30	0,035”		

DM de classe IIb - Conditionnement : par 10

[1] [2] [3] Références : Russel JC.; Bacteria, Biofilm and Devices: The Possible Protective Role of Phosphorylcholine Materials; J. Endourology 2000; 14(1): 39-42 Stickler DJ, Evans A. et al.; Strategies for the control of catheter encrustation; Int. J. of Antimicrobial Agents 2002; 19(6): 499-506 Heidenreich A., Becker T. et al.; Morbidity of internal Ureteral Tuteurs: Prospective randomized Trial of Polyurethane versus Phosphorylcholine Coated stents; Poster # 139 XVIIth Congress of European Association of Urology (EAU) Birmingham 2002

KIT TUTEUR URÉTÉRAL **DOUBLE J LONGUE DURÉE**

Tuteur urétéral

Dispositif d'orientation*
Longueur : 43 cm

Dispositif d'orientation avec raccord*
- Poussoir
- Déconnecteur
- Raccord de fixation

* Selon les références

LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES		TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	Ø MAX FIL GUIDE	ORIENTABLE	RACCORD
Commande	Produit					
220956	EP-41472230-BS	4,7	22-30	0,028”		
220957	EP-41062230-BS	06	22-30	0,035”		
220958	EP-41072230-BS	07	22-30	0,035”		
220959	EP-41082230-BS	08	22-30	0,035”		
220969	EP-474726	4,7	26	0,028”	x	
220970	EP-470624	06	24	0,035”	x	
220971	EP-470626	06	26	0,035”	x	
220972	EP-470628	06	28	0,035”	x	
220973	EP-470630	06	30	0,035”	x	
220974	EP-470724	07	24	0,035”	x	
220975	EP-470726	07	26	0,035”	x	
220976	EP-470728	07	28	0,035”	x	
220977	EP-470730	07	30	0,035”	x	
220978	EP-470824	08	24	0,035”	x	
220979	EP-470826	08	26	0,035”	x	
220980	EP-470828	08	28	0,035”	x	
220981	EP-470830	08	30	0,035”	x	
221011	EP-574726	4,7	26	0,028”	x	x
221012	EP-570624	06	24	0,035”	x	x
221013	EP-570626	06	26	0,035”	x	x
221014	EP-570628	06	28	0,035”	x	x
221015	EP-570630	06	30	0,035”	x	x
221016	EP-570724	07	24	0,035”	x	x
221017	EP-570726	07	26	0,035”	x	x
221018	EP-570728	07	28	0,035”	x	x
221019	EP-570730	07	30	0,035”	x	x
221021	EP-570826	08	26	0,035”	x	x
221022	EP-570828	08	28	0,035”	x	x
222013	EP-414710	4,7	10	0,028”		
222014	EP-414712	4.7	12	0,028”		
222015	EP-414715	4.7	15	0,028”		
222016	EP-414718	4.7	18	0,028”		
222017	EP-414720	4.7	20	0,028”		
222018	EP-414722	4.7	22	0,028”		

DM de classe IIb - Conditionnement : par 10

KIT TUTEUR URÉTÉRAL **DOUBLE J POUR TUMEUR**

YELLOW-STAR TUMEUR STENT

Tuteur urétéral
- Orifices de drainage uniquement sur les crosses
- Embout ouvert
- Revêtement hydrophile

Tuteur bi-matière
- Crosses Green pour confort
- Corps Yellow pour une pause longue durée

Fabriqué en polyuréthane (PUR)
- Lumière interne importante
- Force de rétention importante
- PUR rigide sur le corps et souple sur le cross

Revêtement phosphorylchoine
- Limite le risque d'incrustation et d'infection, pour une utilisation de longue durée
- Morbidité minimisée[1]

Radio-opaque + marqueurs de positionnement
- Pour une visibilité en fluoroscopie et macroscopie

Contenu du Kit

Tuteur urétéral



Dispositif d'orientation*
Longueur : 43 cm

Dispositif d'orientation avec raccord*
- Poussoir
- Déconnecteur
- Raccord de fixation

* Selon les références

[1]Référence : Russel JC.; Bacteria, Biofilm and Devices: The Possible Protective Role of Phosphorylcholine Materials; J. Endourology 2000; 14

KIT TUTEUR URÉTÉRAL **DOUBLE J POUR TUMEUR**

LES RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES		TAILLE (FR/CH)	LONGUEUR (CM)	Ø MAX FIL GUIDE	ORIENTABLE	RACCORD
Commande	Produit					
221352	TU-410622	06	22	0,035”		
221353	TU-410624	06	24	0,035”		
221354	TU-410626	06	26	0,035”		
221355	TU-410628	06	28	0,035”		
221357	TU-410632	06	32	0,035”		
221358	TU-410722	07	22	0,035”		
221359	TU-410724	07	24	0,035”		
221360	TU-410726	07	26	0,035”		
221361	TU-410728	07	28	0,035”		
221362	TU-410730	07	30	0,035”		
221363	TU-410732	07	32	0,035”		
221365	TU-410824	08	24	0,035”		
221367	TU-410828	08	28	0,035”		
221368	TU-410830	08	30	0,035”		
221369	TU-410832	08	32	0,035”		
221389	TU-470624	06	24	0,035”	x	
221390	TU-470626	06	26	0,035”	x	
221391	TU-470628	06	28	0,035”	x	
221392	TU-470630	06	30	0,035”	x	
221395	TU-470724	07	24	0,035”	x	
221396	TU-470726	07	26	0,035”	x	
221397	TU-470728	07	28	0,035”	x	
221398	TU-470730	07	30	0,035”	x	
221401	TU-470824	08	24	0,035”	x	
221402	TU-470826	08	26	0,035”	x	
221403	TU-470828	08	28	0,035”	x	
221425	TU-570624	06	24	0,035”	x	x
221426	TU-570626	06	26	0,035”	x	x
221427	TU-570628	06	28	0,035”	x	x
221428	TU-570630	06	30	0,035”	x	x
221431	TU-570724	07	24	0,035”	x	x
221432	TU-570726	07	26	0,035”	x	x
221433	TU-570728	07	28	0,035”	x	x
221434	TU-570730	07	30	0,035”	x	x
221435	TU-570732	07	32	0,035”	x	x
221438	TU-570826	08	26	0,035”	x	x
221439	TU-570828	08	28	0,035”	x	x
221440	TU-570830	08	30	0,035”	x	x

DM de classe IIb - Conditionnement : par 10

Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY

9, Avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives +33 (0)5 62 57 69 00
+33 (0)5 62 57 69 01 Découvrez notre site **www.aseptinmed.fr**

09.2023 © Asept InMed - N° identification 383600590, RCS Toulouse B 383 600 590 - Fabricant : Urotech - Crédit Photo : Asept InMed et Fotolia - Photos non contractuelles - Dispositifs médicaux stériles à usage unique certifiés CE0124 destinés à restaurer un flux urinaire depuis le rein jusqu'à la vessie - Classes précisées sous chaque tableau de ref. - Veuillez vous référer à la notice pour plus d'informations. Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage. Document à l'usage des professionnels de santé.